


POM. TECHNICZNE
6,9m²

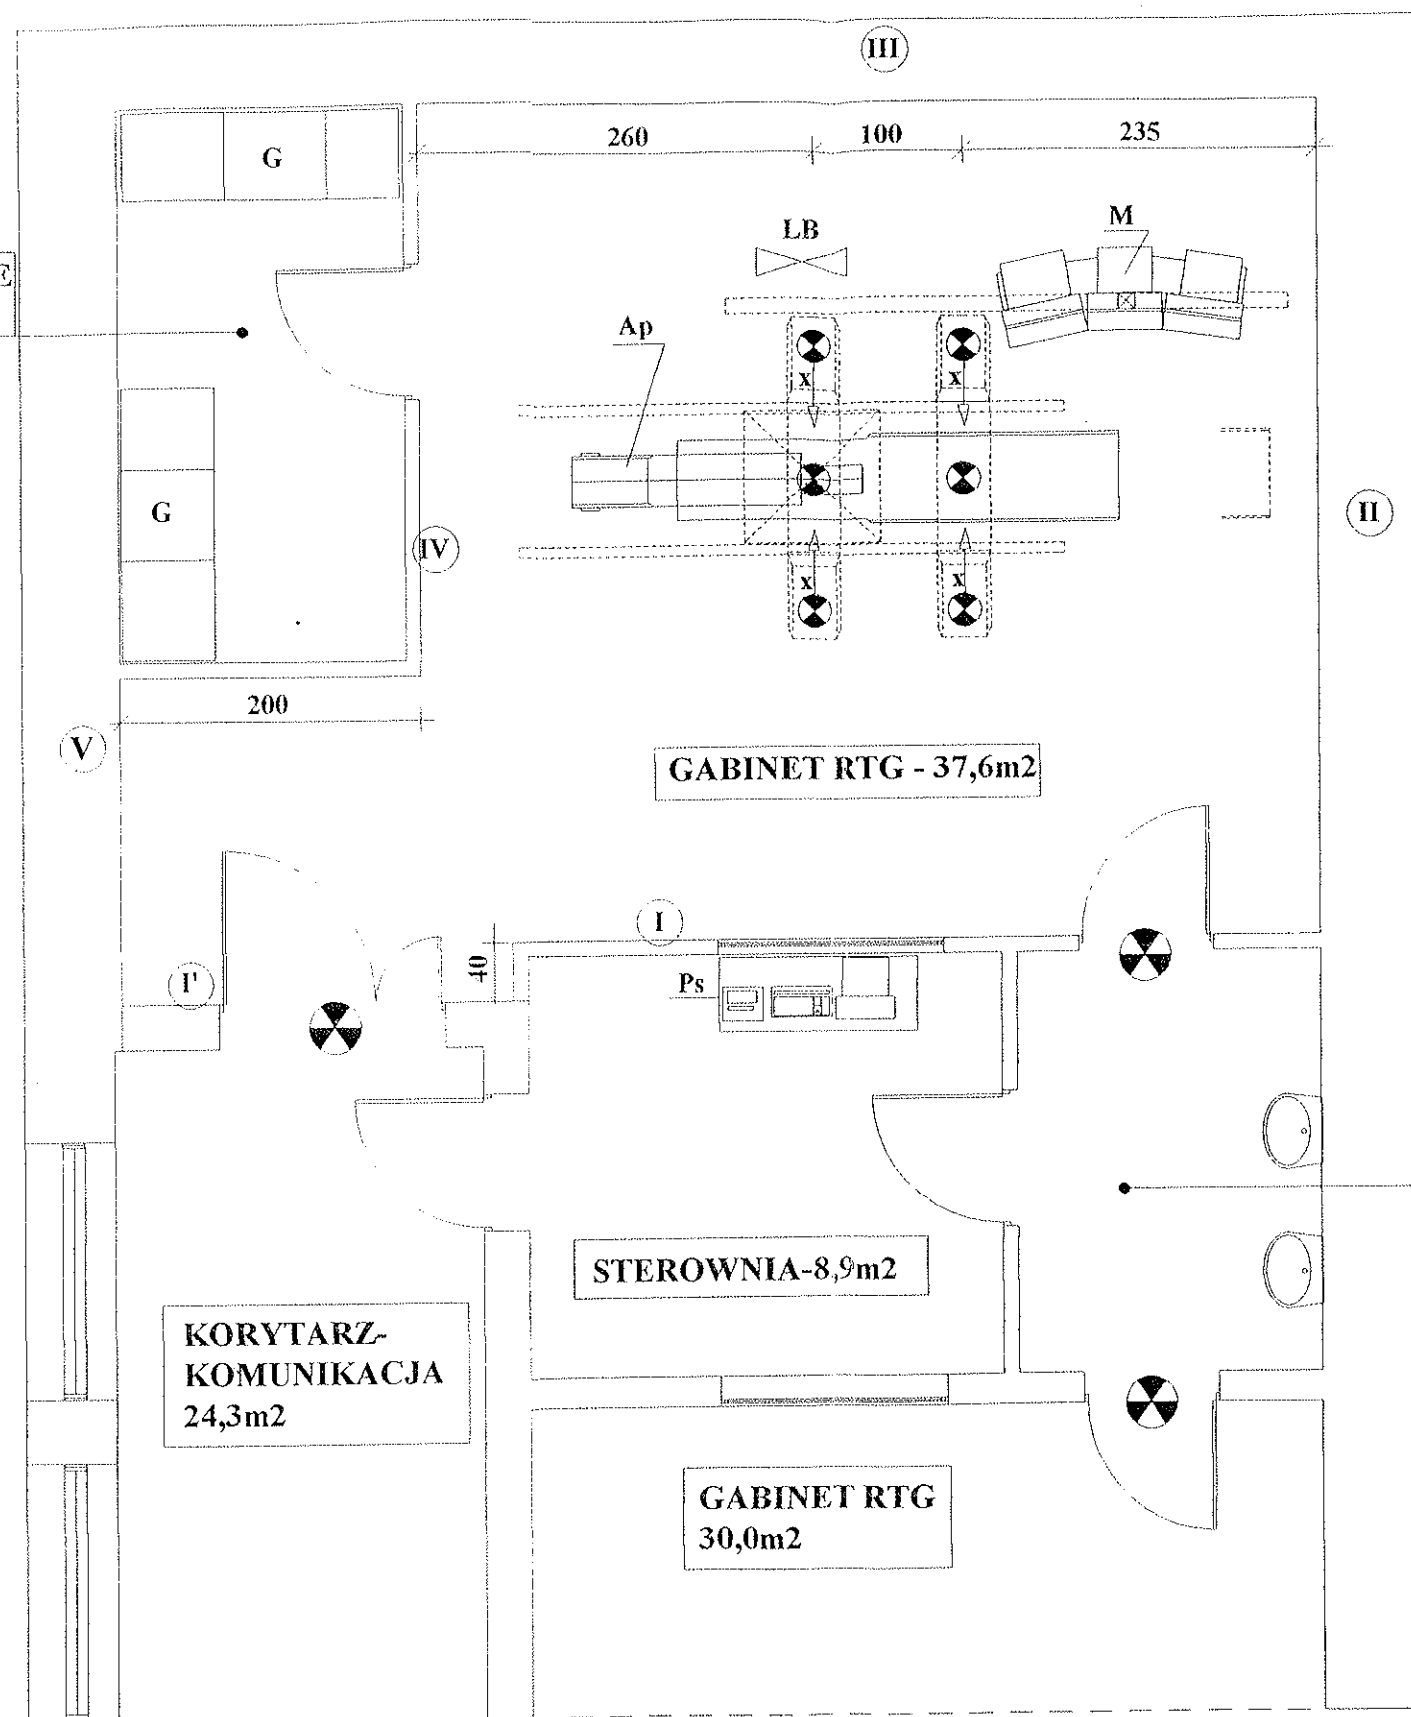

Oznaczenia:

- Ap - aparat rtg "Integris Allura 9C"
M - monitory
X - wiązka pierwotna promieniowania
G - generatory
Ps - panel sterowania
I-V - oznaczenie osłon (ścian)
LB - lampa bakteriobójcza
☢ - sygnalizacja świetlna-oznakowanie

Inwestor :	
Szpital Specjalistyczny nr 8 Zabrze , ul. M.C. Skłodowskiej 10	
Temat :	
Dokumentacja osłon stałych przed promieniowaniem X	
Obiekt :	Skala :
Pracownia hemodynamiki	1 : 50 [cm]
Nazwa :	Nr rysunku :
Rzut I piętra - usytuowanie aparatu rtg	1